Permiso de comercialización INVIMA
2022EBC-0025000

Resolución:
No. 2022003461

Fulltraction



Tecnología avanzada de **Radiofrecuencia íntima**

Estimulación térmica controlada para la regeneración de colageno y elastina y el tensado de la pared vaginal.

TENTREK
LASERS

Gtraction

Synergy Traction

El tratamiento **G-Traction** utiliza radiofrecuencia para generar calor controlado en la canal vaginal y en los tejidos vulvares. Este estímulo térmico favorece la producción y remodelación del colágeno y elastina, contribuyendo a mejorar la firmeza, elasticidad y calidad de los tejidos. Como resultado, puede ayudar a restaurar la tonicidad de la zona íntima y promover una mayor sensación de **bienestar y confort.**

TENTREK LASERS


Indicaciones

Este tratamiento se realiza para:

- **Mejorar la laxitud vaginal tras el parto o debido al envejecimiento**
  - Contracción del colágeno y aumento del tono vaginal
- **Síndrome genitourinario de la menopausia (SGUM)**
  - Mejora de lubricación, pH y trofismo sin terapia hormonal.
- **Tratar la incontinencia urinaria leve de esfuerzo**
  - Tonificación del tejido periuretral y aumento del soporte.
- **Disfunción sexual**
  - Incremento de sensibilidad y respuesta orgásmica. Alivia la sequedad vaginal y mejora la lubricación.
- **Rejuvenecimiento de zona vulvar** (labios mayores atróficos y flacidez)
  - Firmeza de los tejidos por neocolagénesis vaginal y mejora la lubricación.

Copyright © 2026 Tentrek Lasers. All rights reserved

Gtraction

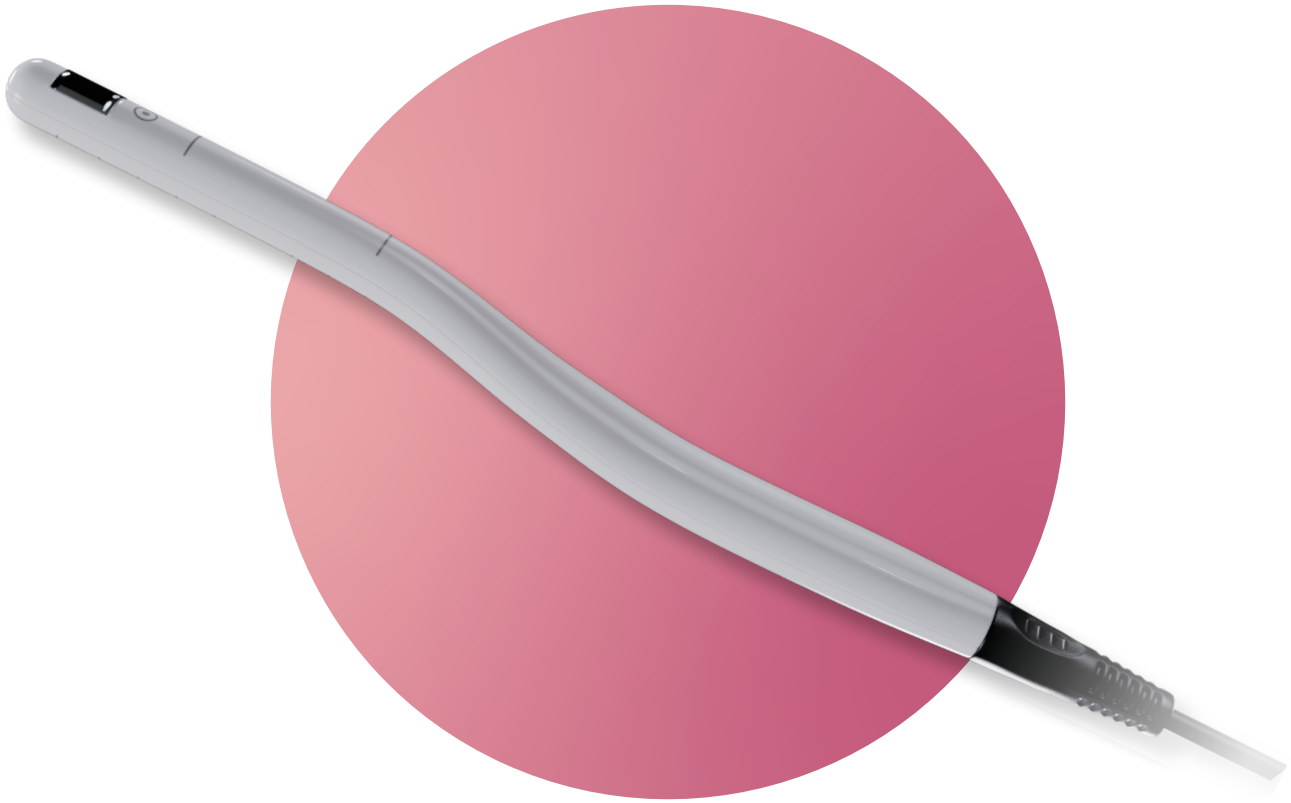

Es un dispositivo de **RF monopolar** que regula la emision de la RF en funcion de la temperatura sensada en el canal vaginal.

La elasticidad vaginal se puede tratar **la incontinencia leve y fortalecimiento de piso pelvico.**


Indicado para mejorar diferentes tratamientos con tan **solo una sesión.**

servicioalcliente@luxomedica.com
www.tentreklasers.com

Sonda

Profundidad máxima de inserción (10 cm)

Electrodo
de emisión RF

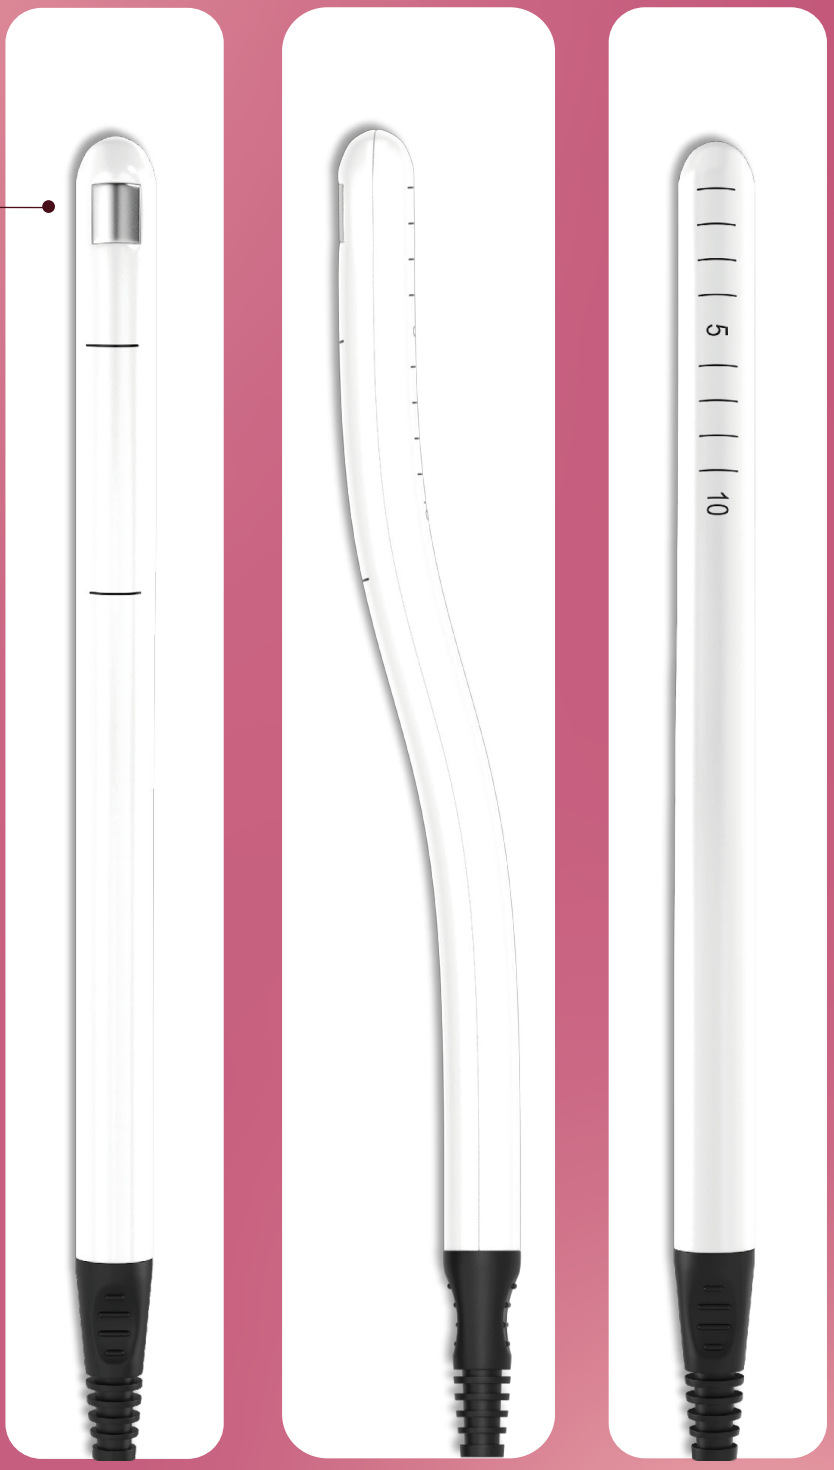


Área de tratamiento principal
(5 ~ 7 cm)

Copyright © 2026 Tentrek Lasers. All rights reserved

*Synergy*Traction



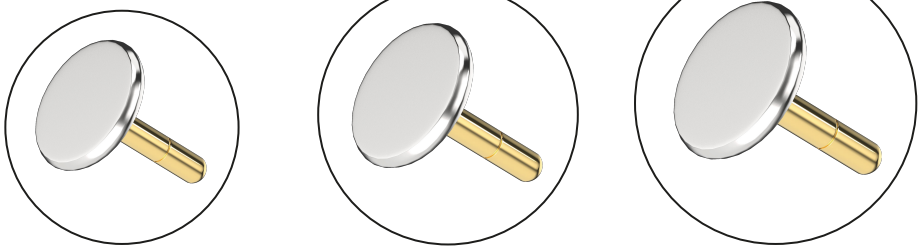

20 mm
(Labios menores)

30 mm
(Labios mayores)

50 mm
(Pubis)

Synergy*Traction*

Modo de uso pieza de mano ginecologica externa

Cuando Retraction - **RET 460kHz RF** tiene contacto con el tejido, se produce calor por el movimiento de los **iones**, el movimiento de rotación de las moléculas polarizadas y la distorsión de las moléculas apolares. Mientras que **la radiofrecuencia** produce un calentamiento controlado en la mucosa y submucosa vaginal, estimulando:

- **Remodelación del colágeno**
- **Activación de fibroblastos**
- **Mejoría en microcirculación**

Retraction-RET aumenta la elasticidad de la piel al aumentar la temperatura de la piel entre **45 ~ 60°C** y estimula los fibroblastos para que **regenere nuevo colágeno.**

Con el electrodo de **30 mm** se realiza tensado de los labios mayores.

Copyright © 2026 Tentrek Lasers. All rights reserved

Contraindicaciones:

- Embarazo
- Marcapasos u otro Implante Electrónico
- Cáncer de Piel
- Lesiones en la Piel
- Infecciones Bacterianas o Virales
- Epilepsia
- Enfermedades Autoinmunes
- Flebitis o enfermedades Vasculares

Se recomienda un tratamiento total de 5 sesiones

(3 primeras sesiones por semana y las 2 últimas sesiones por 2 semanas) se recomienda realizar sesion de manteniiento cada 6 meses.

Paso 1 Emisión de **energía RF**

Paso 2 Regeneración de **colágeno**

Paso 3 **Tensado de los músculos** pélvicos y vaginales internos

Copyright © 2026 Tentrek Lasers. All rights reserved

Fulltraction



TENTREK
LASERS

@Tentreklasers
www.tentreklasers.com

Rv 07.2026